


## 試薬との反応の変化

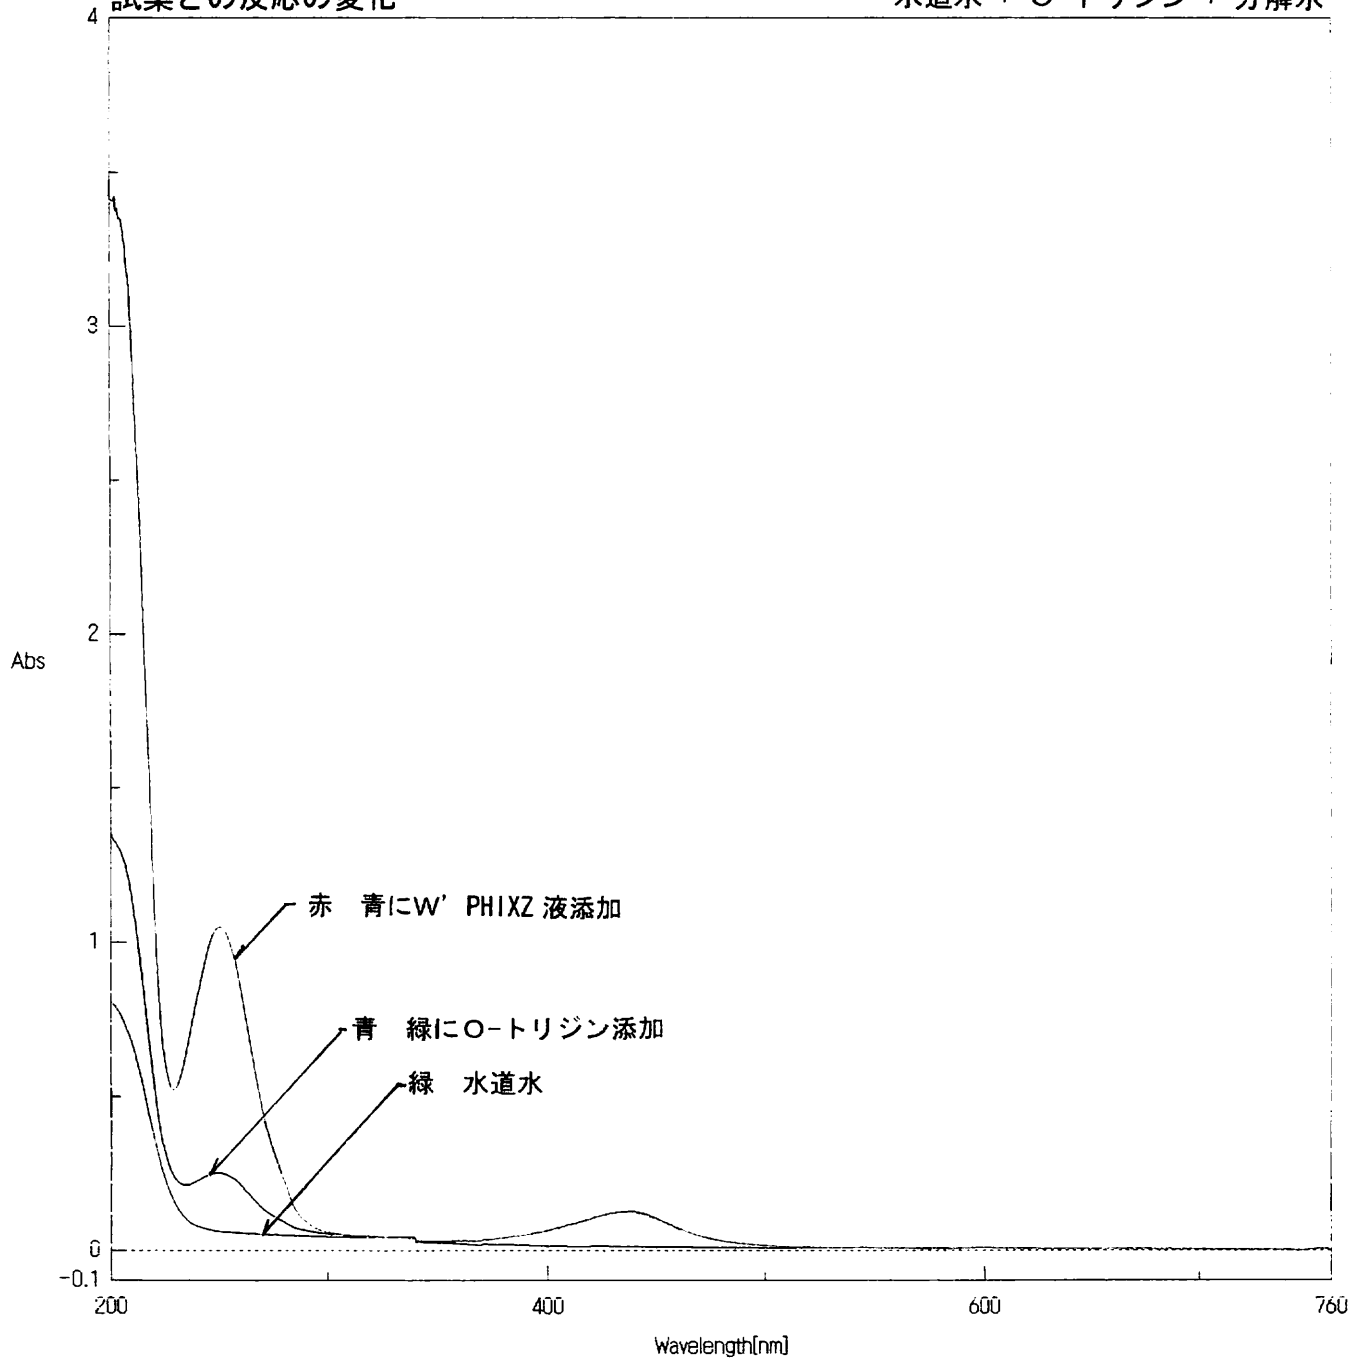

日時	99/11/15 14:26
ファイル名	5水〇分.JWS
機種名	V-560
シリアル番号	C294157
バンド幅	2.0 nm
レスポンス	Medium
測定範囲	760 - 200 nm
データ取込間隔	0.5nm
走査速度	400nm/min
試料番号	118
繰返し回数	1

サンプル名  
測定者  
コメント